


U24-002 Conductivity Accuracy vs. Deviation from Field Calibration Point

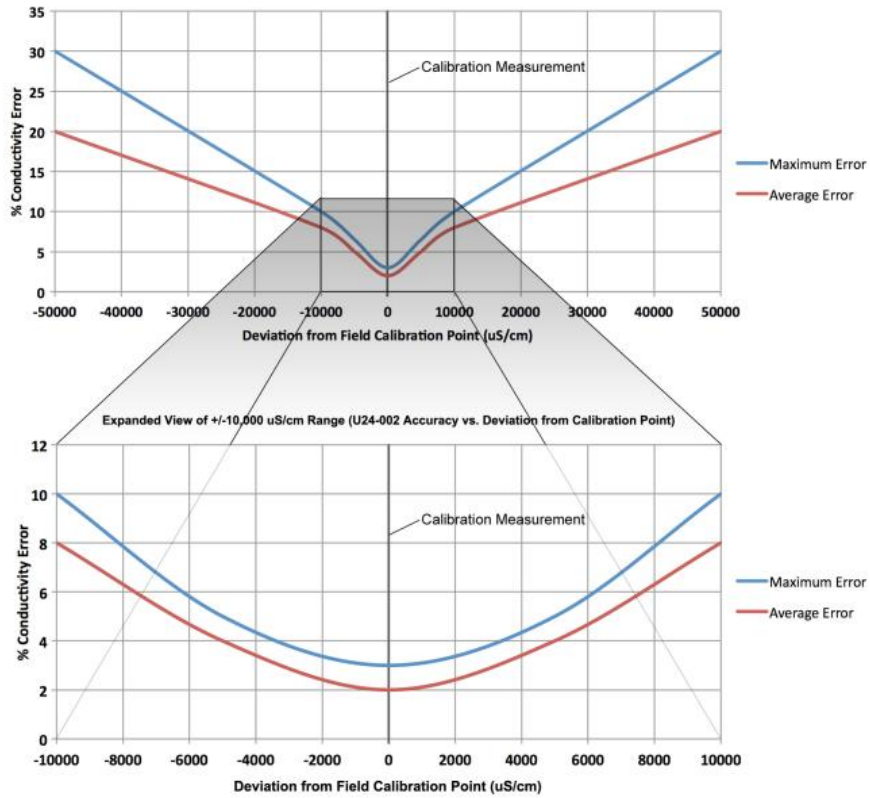

Maximum Error = 最大誤差 Average Error = 通常誤差

%Conductivity Error = 伝導率誤差(%)

Deviation from Field Calibration Point($\mu\text{S/cm}$) = フィールド校正値からの変動